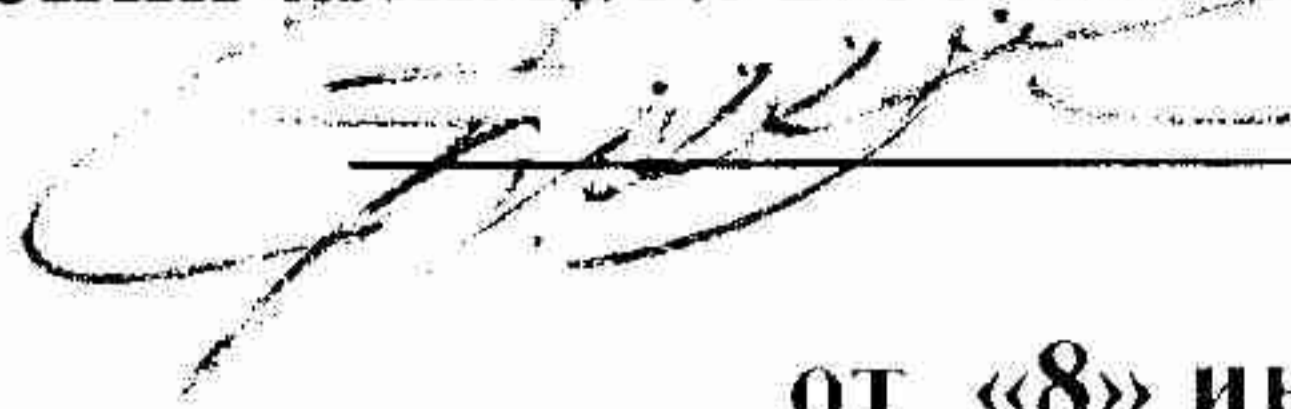


Утверждаю:
Главный врач
КГП «Тарановская центральная районная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
 Уалиев Б.Д.
Приказ № 97
от «8» июня 2020 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закуп медицинской техники в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального
страхования на 2020 год из средств местного бюджета

Заказчик и организатор тендера: Коммунальное государственное предприятие «Районная больница района Беимбета Майлина » Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Место нахождения: 111700, Республика Казахстан, Костанайская область, район Майлина, с. Аиет, ул.Е.Омирзакова,2
Реквизиты: БИН 660640000017, ИИК KZ606010221000017631, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана», КБе 16.
Стоимость документации – предоставляется бесплатно.

1. Общие положения

1.1. Тендер проводится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и от 08.11.2017года №719 «О внесении изменений в постановления Правительства РК» об утверждении **Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Правила) с целью выбора поставщиков медицинской техники для организации здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи из средств местного бюджета.**

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация, информация о выделенной сумме для закупа указаны в Приложении №1 к Тендерной документации (далее - ТД).

2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику

2.1. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования:

- 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

- 2) иметь опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

- 3) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

- 4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- 5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

- 6) иметь разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физического лица или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.

2.2. Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, двухэтапного тендера представляет только одно торговое наименование лекарственного средства либо одного производителя изделия медицинского назначения, медицинской техники, за исключением случая, указанного в пункте 19 настоящих Правил.

2.3. Потенциальный поставщик медицинской техники по одному лоту тендера в случаях, когда для использования с закупаемой основной медицинской техникой дополнительно требуются медицинская техника и (или) изделия медицинского назначения для совместного использования в комплектации, может представить двух и более производителей.

2.4. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет организатору закупа, документы, предусмотренные настоящей тендерной документацией.

Техническая спецификация приложение №2 к ТД

№ п/п	Критерии	Описание												
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ)	Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеры) модель Alcostop 4800												
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения	относится к средствам измерения												
2	Функциональные особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Режим быстрой бесконтактной проверки на наличие алкогольных паров в выдохе человека • Цифровое отображение результата и три режима световой и звуковой индикации • Отсутствие необходимости прямого выдоха • Очень прост в работе (имеет всего 3 кнопки) • Возможность использования не медперсоналом и в полевых условиях • Неограниченная нагрузочная способность • Режим работы без мундштука • Компактные размеры • Возможность отбора пробы воздуха в помещениях, емкостях и дыхания людей находящихся в безраздельном состоянии 												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">№ п/п</td> <td style="width: 40%;"><i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i></td> <td style="width: 45%;"><i>Техническая характеристика комплектующего к МТ</i></td> <td style="width: 10%;"><i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><i>Основные комплектующие</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер) Alcostop 4800</td> <td>Устройство, режимы измерений-пассивный, режим без мундштука Диапазон измерения-0-100мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови)</td> <td align="center">1 шт.</td> </tr> </table>	№ п/п	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Техническая характеристика комплектующего к МТ</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>	<i>Основные комплектующие</i>					Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер) Alcostop 4800	Устройство, режимы измерений-пассивный, режим без мундштука Диапазон измерения-0-100мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови)	1 шт.
№ п/п	<i>Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)</i>	<i>Техническая характеристика комплектующего к МТ</i>	<i>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</i>											
<i>Основные комплектующие</i>														
	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестер) Alcostop 4800	Устройство, режимы измерений-пассивный, режим без мундштука Диапазон измерения-0-100мг/100мл (в единицах концентрации алкоголя в крови)	1 шт.											
3	Требования к комплектации													

5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Костанайская область Тарановский район, с.Айет. ул.Е.Омирзакова, 2
6	Срок поставки МТ и место дислокации	июль 2020 года Адрес: КГП «РБ района Б.Майлина» УЗАКО

Главный врач

КГП «Районная больница района Беимбета Майлина  Уалиев Б.Д.